

臨床検査に関するお知らせ



株式会社セントラル医学検査研究所

TEL(本社)029-225-8858 (下館)0296-28-5900

先生各位

2024年3月

A-24-05

測定試薬変更のお知らせ

拝啓 時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

平素は格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

この度、下記検査項目におきまして、現行試薬販売中止に伴い測定試薬を変更させて頂きたくご案内致します。

何卒ご了承賜りますようお願い申し上げます。

敬具

記

◆ 実施日 2024年4月1日(月) ご依頼分より

◆ 変更内容



2022・23年 検査案内	項目 コード	検査項目	変更箇所	新	旧
p.40	31030	活性化部分トロンボ プラスチン時間 (APTT)	測定試薬	レボヘム APTT-SLA	トロンボチェック APTT-SLA

※ 上記以外の検査要項に変更はございません。

※ 新旧相関図は裏面をご参照ください。

<裏面に続く>

◆新旧の相関 ※社内検討データ

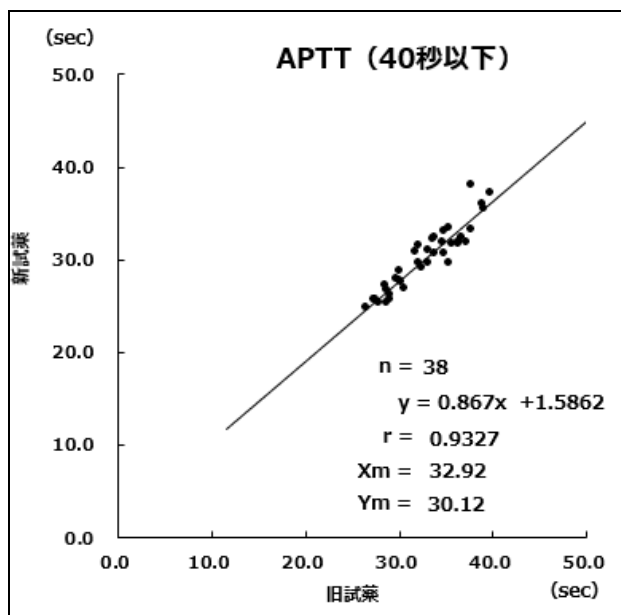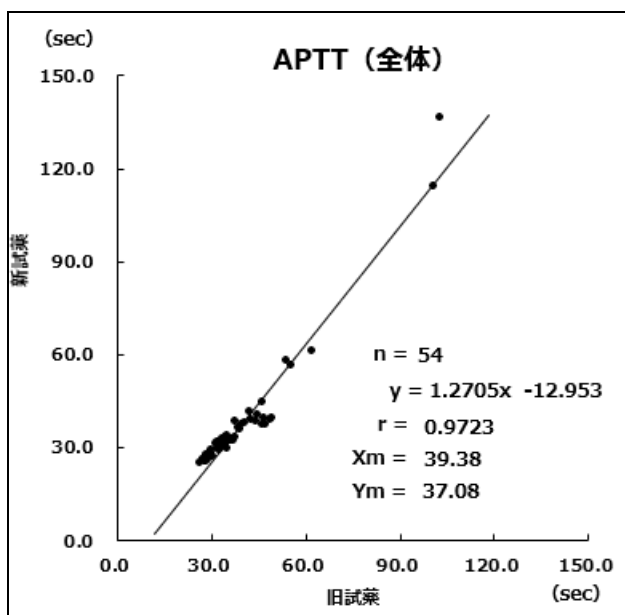

- 正常検体（40 秒以下）については新試薬の方が約 2～3 秒短めの傾向があります。